



Łomża, 29.10.2018 r.

Znak sprawy: KZp.2730.21.18

## Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu medycznego do Sali symulacji wysokiej wierności” (Znak sprawy: KZp.2730.21.18)**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 639617-N-2018.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 ze zmianami), Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zawiadamia, że w dniu 24-25.10.2018r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wobec powyższego Zamawiający wyjaśnia jak poniżej:

### Pytanie nr 1

#### Zadanie nr 1 – Dostawa pompy infuzyjnej objętościowej


Pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z możliwością przechowywanie do 5000 pozycji historii na dużym 4,3” dotykowym, kolorowym wyświetlaczu bez możliwości odczytu jej na pliku XML ? Opcja podglądu historii na pompie jest zdecydowanie wystarczająca dla Zamawiającego, ponieważ eksport do pliku XLM wymaga po pierwsze komputera, a po drugie podłączenia internetowego.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

### Pytanie nr 2

#### Zadanie nr 7 – Dostawa pompy strzykawkowej

Pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z możliwością przechowywanie do 5000 pozycji historii na dużym 4,3” dotykowym, kolorowym wyświetlaczu bez możliwości odczytu jej na pliku XML ? Opcja podglądu historii na pompie



jest zdecydowanie wystarczająca dla Zamawiającego, ponieważ eksport do pliku XLM wymaga pierwsze komputera; a po drugie podłączenia internetowego.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

### Pytanie nr 3

#### Zadanie nr 6 Defibrylator :

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator wyposażony w 4 lub 12 odprowadzeń EKG?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

### Pytanie nr 4

#### Zadanie nr 6 Defibrylator:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez możliwości połączenia z siecią LAN?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

### Pytanie nr 5

#### Zadanie nr 6 Defibrylator :

3. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez pokrywy wyświetlacza ?

Wykonawca oferuje defibrylator wyposażony w kieszenie boczne na elementy wyposażenia.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

### Pytanie nr 6

#### Zadanie nr 6 Defibrylator :

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z przewodem 3, 5, 10 żyłowym i przewodem o długości krótszym niż 2 m ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem w SIWZ.


### Pytanie nr 7

#### Zadanie nr 6 Defibrylator :

Czy Zamawiający wyjaśni pytanie numer 10 dotyczące klipsów 2 i 3 rowkowych ?

Wyjaśnienie: Zamawiający wpisując w SIWZ klipsy (2 lub 3) rowkowe do EKG miał na myśli klipsy, które z łatwością dają się umocować na elektrodach przyklejonych do klatki piersiowej,





symulatora. Do symulatora nie mogą być stosowane klipsy przyssawkowe.

#### Pytanie nr 8

**Dotyczy: Zadanie nr 2 – Dostawa łóżka na stanowisko intensywnej terapii – 2 szt.**

Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 420 mm do 820 mm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 9

**Dotyczy: Zadanie nr 2 – Dostawa łóżka na stanowisko intensywnej terapii – 2 szt.**

Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże 4-sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome; leże wypełnione płytami tworzywowymi HPL, cztery płyty na całe leże; płyty gładkie, łatwo zmywalne, możliwe do demontażu, lekkie, odporne na środki dezynfekujące, zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatraskowy?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 10

**Dotyczy: Zadanie nr 2 – Dostawa łóżka na stanowisko intensywnej terapii – 2 szt.**

Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści łóżko posiadające szczyty tworzywowe z jednolitego odlewu, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem, z blokadą, bez graficznej, kolorystycznej informacji zablokowane / odblokowane?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 11

**Dotyczy: Zadanie nr 2 – Dostawa łóżka na stanowisko intensywnej terapii – 2 szt.**

Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w koła jezdne z tworzywa odpornego na uszkodzenia o średnicy 150 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem?


Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 12

**Dotyczy: Zadanie nr 2 – Dostawa łóżka na stanowisko intensywnej terapii – 2 szt.**

Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści łóżko posiadające hamulec centralny oraz dźwignię

3




nożną dostępną o strony nóg pacjenta, dźwignia dostępna na całej szerokości podstawy?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

### Pytanie nr 13

**Dotyczy: Zadanie nr 2 – Dostawa łóżka na stanowisko intensywnej terapii – 2 szt.**

Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści wyposażone w barierki boczne metalowe lakierowane, składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, barierki boczne składające się z czterech trzech poprzeczek, w celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w dwóch ruchach tj. w sposób świadomy (oburącz) poprzez „odciągnięcie” przycisku zabezpieczającego, a następnie złożenie barierki, przy regulowaniu oparcia pleców barierki nie poruszają się wraz z leżem?

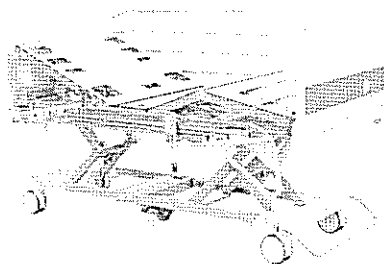


*(Zdjęcie poglądowe łóżka z barierkami metalowymi)*

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem w SIWZ.

### Pytanie nr 14

**Dotyczy: Zadanie nr 2 – Dostawa łóżka na stanowisko intensywnej terapii – 2 szt.**

Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści wyposażone w barierki boczne tworzywowe, składane obok ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, barierki boczne tworzywowe zabezpieczające pacjenta przed wypadnięciem, w celach bezpieczeństwa system opuszczania barierek wspomagany sprężynami gazowymi umożliwiającymi ciche, lekkie i płynne ruchy wykonywane przez personel medyczny, barierki niezależne od siebie z możliwością opuszczenia / odbezpieczenia dowolnej z nich za pomocą klamki dostępnej jedynie dla personelu medycznego, przy regulowaniu oparcia pleców barierki poruszają się wraz z leżem?

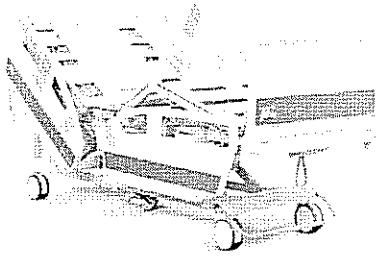

*(Zdjęcie poglądowe łóżka z barierkami tworzywowymi)*

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 15

**Dotyczy: Zadanie nr 2 – Dostawa łóżka na stanowisko intensywnej terapii – 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pilota przewodowego (bez podświetlanych przycisków) oraz centralny panel sterowania dla personelu z regulacją kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, funkcji przechyłów wzdłużnych, autokontur, pozycja antyszokowa, pozycja krzesła kardiologicznego, pozycja CPR, pozycja egzaminacyjna; panel z możliwością zawieszenia na szczycie łóżka od strony nóg oraz podwieszenia pod półką na pościel, panel posiadający czytelne piktogramy w celu bardziej intuicyjnej obsługi?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 16

**Dotyczy: Zadanie nr 2 – Dostawa łóżka na stanowisko intensywnej terapii – 2 szt.**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści łóżko posiadające wyłączniki / blokady funkcji elektrycznych (uruchamiane na panelu sterowniczym dla personelu) dla poszczególnych regulacji:

- regulacji wysokości
- regulacji części plecowej
- regulacji części nożnej
- przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga
- funkcji autokontur

Diodowe wskaźniki informujące o zablokowanych regulacjach w panelu dla personelu oraz w pilocie dla pacjenta?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.



#### Pytanie nr 17

**Dotyczy: Zadanie nr 2 – Dostawa łóżka na stanowisko intensywnej terapii – 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku bezpieczeństwa opisanego w pkt. 18? W oferowanym łóżku jest możliwość odłączenia (zablokowania) wszystkich funkcji (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) poprzez selektywną blokadę funkcji elektrycznych.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 18

**Dotyczy: Zadanie nr 2 – Dostawa łóżka na stanowisko intensywnej terapii – 2 szt.**

Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w akumulator wskaźnikiem stanu naładowania w panelu sterownia dla personelu, bez diodowego wskaźnika informującego dodatkowo o konieczności wymiany baterii?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 19

**Dotyczy: Zadanie nr 3 – Dostawa wózka reanimacyjnego dla dzieci z wyposażeniem – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający głębokość 61 cm? Oferowany wymiar różni się tylko o 1 cm od wskazanego przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 20


**Dotyczy: Zadanie nr 3 – Dostawa wózka reanimacyjnego dla dzieci z wyposażeniem – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający szerokość (wraz z zintegrowanym uchwytem do prowadzenia) 91 cm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 21

**Dotyczy: Zadanie nr 3 – Dostawa wózka reanimacyjnego dla dzieci z wyposażeniem – 1 szt.**



Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek posiadający szuflady, które nie są samoczynnie domykające się?

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem w SIWZ.

#### Pytanie nr 22

**Dotyczy: Zadanie nr 3 – Dostawa wózka reanimacyjnego dla dzieci z wyposażeniem – 1 szt.**

Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści wózek posiadający układ jezdny wysoce mobilny, wyposażony w 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą oraz 1 antystatyczne, o średnicy 125 mm, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w prostokącie, w odległościach zapewniających zwrotność wózka? Proponowane rozwiązanie nie ma negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe wózka.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 23

**Dotyczy: Zadanie nr 3 – Dostawa wózka reanimacyjnego dla dzieci z wyposażeniem – 1 szt.**

Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wózek posiadający w narożnikach (nad kołami) odboje chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.


Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 24

**Dotyczy: Zadanie nr 3 – Dostawa wózka reanimacyjnego dla dzieci z wyposażeniem – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pojemnik na odpady medyczne z tworzywa z pokrywą otwieraną kolanem?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.



#### Pytanie nr 25

**Dotyczy: Zadanie nr 3 – Dostawa wózka reanimacyjnego dla dzieci z wyposażeniem – 1 szt.**


Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pojemnik na akcesoria (zamiast koszyka na akcesoria)?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 26

**Dotyczy: Zadanie nr 3 – Dostawa wózka reanimacyjnego dla dzieci z wyposażeniem – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony w „zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalającą na ich identyfikację”?

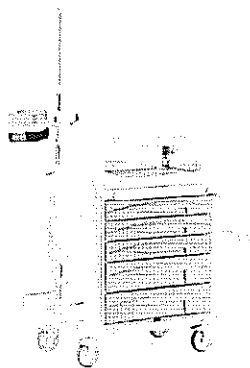

(Zdjęcie poglądowe wózka)

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 27

**Dotyczy: Zadanie nr 5– Dostawa wózka reanimacyjnego z wyposażeniem – 2szt.**

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający głębokość 61 cm? Oferowany wymiar różni się tylko o 1 cm od wskazanego przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.





#### Pytanie nr 28

**Dotyczy: Zadanie nr 5– Dostawa wózka reanimacyjnego z wyposażeniem – 2szt.**

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający szerokość (wraz z zintegrowanym uchwytem do prowadzenia) 91 cm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 29

**Dotyczy: Zadanie nr 5– Dostawa wózka reanimacyjnego z wyposażeniem – 2szt.**

Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek posiadający szuflady, które nie są samoczynnie domykające się?

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem w SIWZ

#### Pytanie nr 30

**Dotyczy: Zadanie nr 5– Dostawa wózka reanimacyjnego z wyposażeniem – 2szt.**

Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści wózek posiadający układ jezdny wysoce mobilny, wyposażony w 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą oraz 1 antystatyczne, o średnicy 125 mm, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w prostokącie, w odległościach zapewniających zwrotność wózka? Proponowane rozwiązanie nie ma negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe wózka.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 31

**Dotyczy: Zadanie nr 5– Dostawa wózka reanimacyjnego z wyposażeniem – 2szt.**


Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wózek posiadający w narożnikach (nad kołami) odboje chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 32

**Dotyczy: Zadanie nr 5– Dostawa wózka reanimacyjnego z wyposażeniem – 2szt.**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pojemnik na odpady medyczne z tworzywa z



pokrywą otwieraną kolaniem?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 33

**Dotyczy: Zadanie nr 5– Dostawa wózka reanimacyjnego z wyposażeniem – 2szt.**


Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pojemnik na akcesoria (zamiast koszyka na akcesoria)?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 34

**Dotyczy: Zadanie nr 5– Dostawa wózka reanimacyjnego z wyposażeniem – 2szt.**

Czy Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony w „zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalającą na ich identyfikację”?

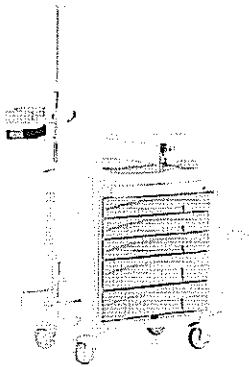


(Zdjęcie poglądowe wózka)

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 35

**Zadanie nr 3 - Dostawa wózka reanimacyjnego dla dzieci z wyposażeniem (1 szt.)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego układ jezdny wysoce mobilny tworzą 4 obrotowe koła  $\varnothing$  150 mm, w tym 2 z blokadą i 2 antystatyczne, nie brudzące podłoża, rozmieszczone w sposób zapewniający doskonałą zwrotność wózka.



Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

### Pytanie nr 36

#### Zadanie nr 3 - Dostawa wózka reanimacyjnego dla dzieci z wyposażeniem (1 szt.)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego dół zabezpieczony jest odbojem na całym obwodzie, wykonany z tworzywa ABS, chroniący wózek i ściany przed uszkodzeniem.


Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

### Pytanie nr 37

#### Zadanie nr 3 - Dostawa wózka reanimacyjnego dla dzieci z wyposażeniem (1 szt.)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka reanimacyjnego z następującym wyposażeniem:

- blat zabezpieczony z trzech stron przed zsuwaniem się przedmiotów
- wysuwany blat boczny
- uchwyt na butlę z tlenem (wyprofilowany w tylnej ścianie wózka)
- uchwyt na pojemnik do zużytych igieł
- półka pod defibrylator o regulowanych wymiarach
- wieszak kroplówki z 2 haczykami
- kosz na odpady otwarty, z wyjmowanym wkładem do mycia i dezynfekcji
- 2 transparentne umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane o 30° pojemniki „kieszenie”, z możliwością wyjęcia do czyszczenia - z przeznaczeniem na akcesoria i narzędzia
- wyciągane podziałki do szuflad służące odpowiedniej segregacji zawartości
- zamek centralny
- możliwość oznaczenia szuflad
- wózek wyposażony w 5 szuflad (2 szuflady o wysokości 76 mm w tym 1 z organizerem na poszczególne ampułki, 2 szuflady o wysokości 156 mm, 1 szuflada o wysokości 236 mm) - standardowa konfiguracja szuflad dla wózków reanimacyjnych; szuflady z możliwością wyjęcia bez użycia narzędzi
- przestrzeń na cewniki (wyprofilowana w tylnej ścianie wózka)
- półka o regulowanej głębokości (np. z przeznaczeniem na ssak)
- dzielona nadstawka górna (na próbki do pobierania krwi, igły, wenflony itp.)

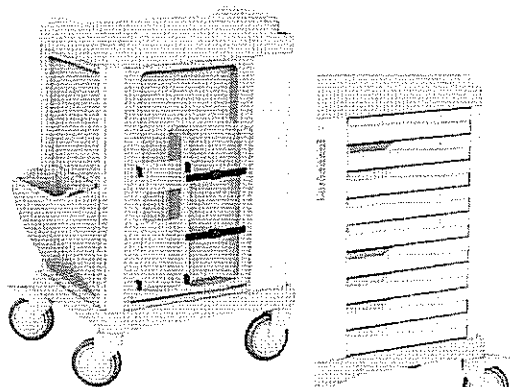


Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

### Pytanie nr 38


#### Zadanie nr 3 - Dostawa wózka reanimacyjnego dla dzieci z wyposażeniem (1 szt.)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, w którym możliwy jest wybór kolorystyki oznaczeń uchwytów szuflad (9 kolorów oznaczeń do wyboru).

*(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka poniżej)*

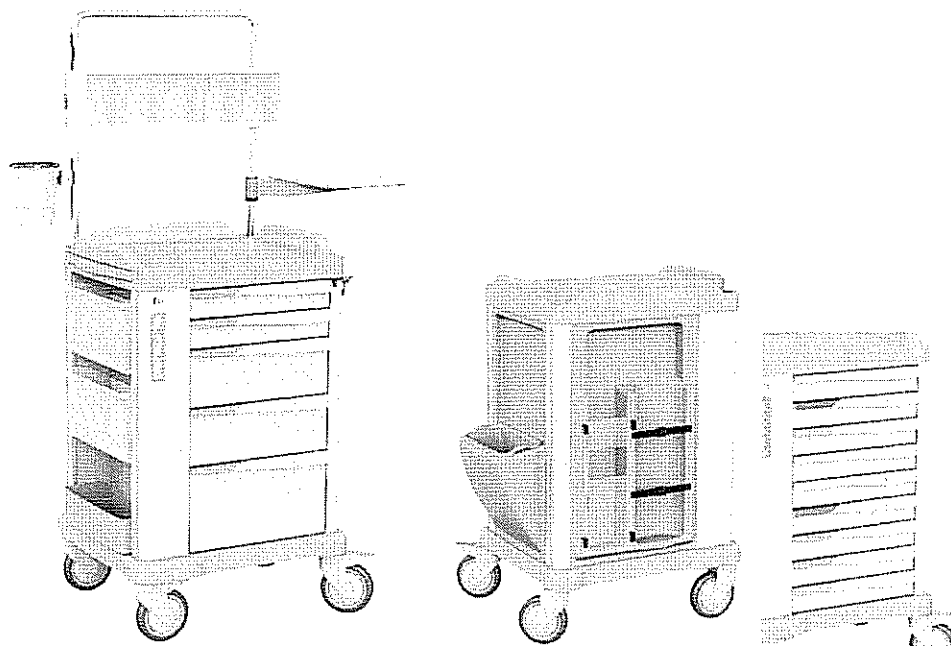

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.



**Pytanie nr 39**

**Dotyczy SIWZ (Zadanie nr 3)**

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu instalacji oferowanego wózka. Zamawiający otrzymuje wózek w postaci nadającej się do użytku, żadne takie czynności instalacyjne nie są zatem konieczne. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że wózek dotrze kompletny bez potrzeby składania poszczególnych elementów przez Zamawiającego, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 40**

**Dotyczy SIWZ (Zadanie nr 3)**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu skutecznej naprawy z 7 do 14 dni roboczych przewidzianego w załączniku nr 2 do SIWZ pkt 17 do Zadania nr 3, w przypadku konieczności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy. W przypadku konieczności ściągnięcia sprzętu/ części zamiennych z zagranicy czas realizacji naprawy znacząco się wydłuża z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 41**

**ZADANIE NR 4 – Dostawa inkubatora otwartego**

Dotyczy pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści nowoczesny i bardzo wydajny i energooszczędny promiennik z mocą 500W?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 42**

**ZADANIE NR 4 – Dostawa inkubatora otwartego**

Dotyczy pkt 5 Czy Zamawiający dopuści obracaną głowicę w zakresie 170 stopni?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ



#### ZADANIE NR 43 – Dostawa inkubatora otwartego

Dotyczy pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści nowoczesny inkubator z zakresem regulacji temperatury w zakresie 34-38°C co jest parametrem zupełnie wystarczającym ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

#### Pytanie nr 44

#### ZADANIE NR 4 – Dostawa inkubatora otwartego

Dotyczy pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści nowoczesny inkubator z regulacją pochylenia leżą w zakresie  $0 \pm 13^\circ$ ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

#### Pytanie nr 45

#### ZADANIE NR 4 – Dostawa inkubatora otwartego

Dotyczy pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści stanowisko komunikujące się za pomocą cyfr i symboli graficznych ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 46

#### ZADANIE NR 4 – Dostawa inkubatora otwartego

Dotyczy pkt. 18. Czy w miejsce opisanego wymogu, Zamawiający dopuści Wyświetlacz typu LED jednokolorowy z wydzieloną osobną sekcją dla temperatury, mocy grzałki, zegara APGAR oraz alarmami w postaci symboli graficznych i sygnału dźwiękowego?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 47

#### ZADANIE NR 4 – Dostawa inkubatora otwartego

Dotyczy pkt 20. Czy Zamawiający dopuści stanowisko bez półki na dodatkowe wyposażenie?

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisami w SIWZ.



**Pytanie nr 48**

**ZADANIE NR 4 – Dostawa inkubatora otwartego**

Dotyczy pkt 21 Czy z uwagi na posiadane w inkubator wbudowane oświetlenie o mocy 600 LUX, Zamawiający dopuści stanowisko bez dodatkowej lampy wymienionej w tym punkcie?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 49**

**ZADANIE NR 4 – Dostawa inkubatora otwartego**

Dotyczy pkt 21. Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w nowoczesne i bardzo wydajne oświetlenie LED o mocy światła 600 LUX?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 50**

**ZADANIE NR 4 – Dostawa inkubatora otwartego**

Dotyczy pkt. 23 Czy poprzez Zegar, Zamawiający miał również na myśli stanowisko wyposażone w zegar (CPR) sygnalizujący co 30 sekund czas na ocenę prowadzonej resuscytacji?

Wyjaśnienie: Tak

**Pytanie nr 51**

**ZADANIE NR 4 – Dostawa inkubatora otwartego**

Dotyczy pkt. 24 Czy Zamawiający dopuści stanowisko bez możliwości regulacji wysokości?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.


**Pytanie nr 52**

**ZADANIE NR 4 – Dostawa inkubatora otwartego**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania stanowiska wyposażonego w ścianki wyposażone w mechanizm wolnego opadania?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

W celu zagwarantowania dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **05.11.2018 r.** do godziny **12:00**.



Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 ze zmianami). Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

1) w SIWZ pkt. 1 i 3 w Dziale XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

**Było:**

1. Oferty należy składać do dnia: **31.10.2018 r.** do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:  
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży  
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat Kanclerza)
3. Oferty zostaną otwarte dnia **31.10.2018 r.** o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego:  
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży  
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter

**Winno być:**

1. Oferty należy składać do dnia: **05.11.2018 r.** do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:  
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży  
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat Kanclerza)
3. Oferty zostaną otwarte dnia **05.11.2018 r.** o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego:  
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży  
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto działając na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie. Zmianę ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu dzisiejszym.

*W imieniu Zamawiającego*

p.o. KANCLERZ

*mgr inż. Artur Baldowski*