

Łomża, 11.03.2019 r.

Znak sprawy: KZp.2730.6.19

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu medycznego do Sali wysokiej wierności Centrum Symulacji Medycznej” (Znak sprawy: KZp.2730.6.19)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 521759-N-2019 z dnia 06.03.2019 r.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami), Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zawiadamia, że w dniach 07,08,09.03.2019 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wobec powyższego Zamawiający wyjaśnia jak poniżej:

Pytanie 1

Zadanie nr 2 – Dostawa wózka reanimacyjnego – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający głębokość 61 cm? Oferowany wymiar różni się tylko o 1 cm od wskazanego przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Zadanie nr 2 – Dostawa wózka reanimacyjnego – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający szerokość (wraz z zintegrowanym uchwytem do prowadzenia) 91 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

Zadanie nr 2 – Dostawa wózka reanimacyjnego – 1 szt.



Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający układ jezdny wysoce mobilny, wyposażony w 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą oraz 1 antystatyczne, o średnicy 125 mm, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w prostokącie, w odległościach zapewniających zwrotność wózka?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Zadanie nr 2 – Dostawa wózka reanimacyjnego – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający w narożnikach (nad kołami) odboje chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

Zadanie nr 2 – Dostawa wózka reanimacyjnego – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pojemnik na odpady medyczne z tworzywa z pokrywą otwieraną kolanem?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

Zadanie nr 2 – Dostawa wózka reanimacyjnego – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pojemnik na akcesoria (zamiast koszyka na akcesoria)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie 7

Zadanie nr 2 – Dostawa wózka reanimacyjnego – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony w „zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikację”?

Wyjaśnienie:



Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie 8

Dotyczy: Zadanie nr 1 – Dostawa inkubatora otwartego – 1 szt.

Ad. 9. Czy zamawiający dopuści inkubator z utrzymaniem nastawionej temperatury z dokładnością +/- 0,3 °C? Jest to niewielka różnica względem wymaganej przez zamawiającego +/- 0,2 °C

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie 9

Dotyczy: Zadanie nr 1 – Dostawa inkubatora otwartego – 1 szt.

Ad. 13. Czy zamawiający dopuści inkubator ze ścianką górną z możliwością wyjmowania bez użycia narzędzi, z 2-ma otworami zaopatrzonymi w uszczelki do mocowania przewodów (dwa górne)? Dwa otwory przepustowe wystarczą do przeprowadzenia niezbędnych do pielęgnacji noworodka przewodów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Dotyczy: Zadanie nr 1 – Dostawa inkubatora otwartego – 1 szt.

Ad. 14. Czy zamawiający dopuści podstawę jezdną inkubatora osadzoną na 4 kółkach z blokadą 4 kółek, kółka nieprzewodzące ładunków elektrostatycznych? Kółka nieprzewodzące ładunków elektrostatycznych zapobiegają elektryzowaniu się powierzchni inkubatora, poprawiając komfort pracy personelu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie 11

Dotyczy: Zadanie nr 1 – Dostawa inkubatora otwartego – 1 szt.

Ad. 21. Czy zamawiający dopuści lampę łączącą funkcję wiązki światła punktowego (do oświetlenia miejsca zabiegu), z oddzielną lampą do fototerapii?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.



Pytanie 12

Dotyczy: Zadanie nr 1 – Dostawa inkubatora otwartego – 1 szt.

Ad.22 Czy zamawiający dopuści oświetlenie podstawowe za pomocą 4 diod LED o łącznej mocy 40W? Oświetlenie LED zapewnia komfortową jasność oświetlenia przy mocy 40W, jest energooszczędne i bezpieczne dla personelu oraz pacjenta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie 13

Dotyczy: Zadanie nr 1 – Dostawa inkubatora otwartego – 1 szt.

Ad. 23. Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w zegar APGAR o następujących interwałach czasowych: 1 min, 5 min, 10 min, sygnalizacja optyczna i akustyczna?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Dotyczy: Zadanie nr 2 – Dostawa wózka reanimacyjnego – 1 szt.

Zadanie nr 2 - Dostawa wózka reanimacyjnego z wyposażeniem (1 szt.)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego układ jezdny wysoce mobilny tworzą 4 obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 z blokadą i 2 antystatyczne, nie brudzące podłoża, rozmieszczone w sposób zapewniający doskonałą zwrotność wózka.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie 15

Dotyczy: Zadanie nr 2 – Dostawa wózka reanimacyjnego – 1 szt.


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego dół zabezpieczony jest odbojem na całym obwodzie, wykonany z tworzywa ABS, chroniący wózek i ściany przed uszkodzeniem.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Dotyczy: Zadanie nr 2 – Dostawa wózka reanimacyjnego – 1 szt.



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka reanimacyjnego z następującym wyposażeniem:

- blat zabezpieczony z trzech stron przed zsuwaniem się przedmiotów
- wysuwany blat boczny
- uchwyt na butlę z tlenem (wyprofilowany w tylnej ścianie wózka)
- uchwyt na pojemnik do zużytych igieł
- półka pod defibrylator o regulowanych wymiarach
- wieszak kroplówki z 2 haczykami
- kosz na odpady otwarty, z wyjmowanym wkładem do mycia i dezynfekcji
- 2 transparentne umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane o 30° pojemniki „kieszenie”, z możliwością wyjęcia do czyszczenia - z przeznaczeniem na akcesoria i narzędzia
- wyciągane podziałki do szuflad służące odpowiedniej segregacji zawartości
- zamek centralny (blokada), z dodatkowym zabezpieczeniem na plomby
- możliwość oznaczenia szuflad
- wózek wyposażony w 5 szuflad (2 szuflady o wysokości 76 mm w tym 1 z organizerem na poszczególne ampułki, 2 szuflady o wysokości 156 mm, 1 szuflada o wysokości 236 mm) - standardowa konfiguracja szuflad dla wózków reanimacyjnych; szuflady z możliwością wyjęcia bez użycia narzędzi
- przestrzeń na cewniki (wyprofilowana w tylnej ścianie wózka)
- półka o regulowanej głębokości (np. z przeznaczeniem na ssak)
- dzielona nadstawka górna (na próbki do pobierania krwi, igły, wenflony itp.)

Wyjaśnienie:


Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie 17

Dotyczy: Zadanie nr 2 – Dostawa wózka reanimacyjnego – 1 szt.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, w którym możliwy jest wybór kolorystyki oznaczeń uchwytów szuflad (9 kolorów oznaczeń do wyboru).

(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka poniżej)

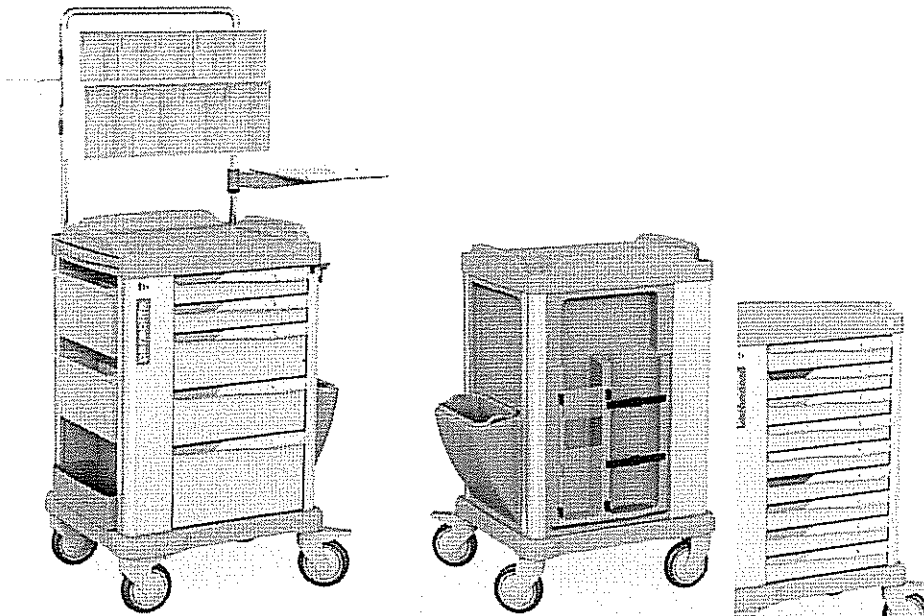

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Dotyczy: Zadanie nr 2 – Dostawa wózka reanimacyjnego – 1 szt.

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu instalacji oferowanego wózka. Zamawiający otrzymuje wózek w postaci nadającej się do użytku, żadne takie czynności instalacyjne nie są zatem konieczne. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że wózek dotrze kompletny bez potrzeby składania poszczególnych elementów przez Zamawiającego, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie 19

Dotyczy: Zadanie nr 2 – Dostawa wózka reanimacyjnego – 1 szt.

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu skutecznej naprawy z 7 do 14 dni roboczych przewidzianego w załączniku nr 2 do SIWZ pkt 17 do Zadania nr 2, w przypadku konieczności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy. W przypadku konieczności ściągnięcia sprzętu/ części zamiennych z zagranicy czas realizacji naprawy znacząco się wydłuży z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.

Wyjaśnienie:





Zamawiający dopuszcza pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Dotyczy: Zadanie nr 2 – Dostawa wózka reanimacyjnego – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego konstrukcja opiera się na aluminiowych, solidnych kolumnach, co gwarantuje solidne wykonanie oraz niewygórowaną masę wózka, natomiast ściany boczne i tylnia wózka wykonane są z lekkiego, solidnego, nierdzewnego kompozytu aluminium? Błat roboczy ze stali nierdzewnej, fronty szuflad ze stali lakierowanej proszkowo.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21

Dotyczy: Zadanie nr 2 – Dostawa wózka reanimacyjnego – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony w centralny zamek wszystkich szuflad – zamykany na klucz, o wymiarach:

- wysokość: 900mm,
- szerokość: 650mm,
- głębokość: 475mm,

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22

Dotyczy: Zadanie nr 2 – Dostawa wózka reanimacyjnego – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego szuflady nie są jednoczęściowe? Nasze szuflady wykonane są z solidnego aluminium oraz stali lakierowanej, zamiast tworzywa – co stanowi o wiele trwalsze rozwiązanie od opisanego.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Dotyczy: Zadanie nr 2 – Dostawa wózka reanimacyjnego – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony w układ jezdny składający się z 4 kół o średnicy 100mm, z czego 3 posiadają



hamulce, a jedno blokadę do jazdy kierunkowej? Wykonane z bieżnikiem nie brudzącym posadzek, rozmieszczone na planie prostokąta dla lepszej stabilności wózka.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Dotyczy: Zadanie nr 2 – Dostawa wózka reanimacyjnego – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego podstawa posiada wyprofilowane nad każdym kołem odboje, chroniące wózek przed obiciami o ściany?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

Dotyczy: Zadanie nr 2 – Dostawa wózka reanimacyjnego – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony w:

- blat roboczy ze stali nierdzewnej zabezpieczony z 3 stron przed zsuwaniem się przedmiotów,
- dodatkowy wysuwany blat boczny z tworzywa ABS,
- uchwyt na butlę z tlenem montowany do szyny z boku wózka,
- pojemnik na zużyte igły,
- obrotowa o 360° półka pod defibrylator,
- wieszak kroplówki z regulacją wysokości,
- 2 tworzywowe kosze z pokrywkami na odpady montowane do szyny z boku wózka,
- koszyk na akcesoria,
- centralny zamek wszystkich szuflad,
- wyciągane podziałki w szufladach umożliwiające lepszą organizację przestrzeni?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Dotyczy: Zadanie nr 1 – Dostawa inkubatora otwartego – 1 szt.



Dotyczy pkt. 5. Czy poprzez „ogrzewacz promiennikowy z obrotową głowicą umożliwiającą dostęp do noworodka i jego pielęgnację od strony główki” Zamawiający miał na myśli ogrzewacz umieszczony na dwóch osobnych kolumnach umiejscowionych po bokach inkubatora, które umożliwiają pełen dostęp do główki pacjenta od tylnej strony inkubatora (od kolumn)?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Dotyczy: Zadanie nr 1 – Dostawa inkubatora otwartego – 1 szt.

Dotyczy pkt. 11. Czy Zamawiający oczekuje aby dostęp do szuflady na kasetę RTG był od trzech stron (wsuwała-wysuwała się po obydwu stronach lewa/ prawo i od strony przedniej podstawy materacyka)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza również dostęp z jednej strony, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

Dotyczy: Zadanie nr 1 – Dostawa inkubatora otwartego – 1 szt.

Dotyczy pkt. 13. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania stanowiska wyposażonego w ścianki posiadające mechanizm wolnego opadania co może uchronić przed ewentualnym zniszczeniem i skraca czas otwierania?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 29

Dotyczy: Zadanie nr 1 – Dostawa inkubatora otwartego – 1 szt.

Dotyczy pkt. 19. Czy Zamawiający dopuści stanowisko bez półki na dodatkowe wyposażenie?


Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 30

Dotyczy: Zadanie nr 1 – Dostawa inkubatora otwartego – 1 szt.

Dotyczy pkt. 21. Czy z uwagi na posiadane w inkubatorze wbudowane oświetlenie o mocy



600 LUX, Zamawiający dopuści stanowisko bez dodatkowej lampy łączącej funkcję wiązki światła punktowego i lampy diodowej do fototerapii?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie 31

Dotyczy: Zadanie nr 1 – Dostawa inkubatora otwartego – 1 szt.

Dotyczy pkt. 22. Czy Zamawiający dopuści oświetlenie diodowe 500-2000 LUX (w odległości 30 cm od źródła światła), które jest nowocześniejszym i bardziej wydajnym rozwiązaniem?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie 32

Dotyczy: Zadanie nr 1 – Dostawa inkubatora otwartego – 1 szt.

Dotyczy pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści stanowisko bez możliwości regulacji wysokości stojaka?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33

Dotyczy: Zadanie nr 1 – Dostawa inkubatora otwartego – 1 szt.

Dot. pkt. 21. - Czy Zamawiający dopuści inkubator bez wagi lampy diodowej do fototerapii?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie 34

Dotyczy: Zadanie nr 1 – Dostawa inkubatora otwartego – 1 szt.

Dot. pkt. 25 - Czy Zamawiający dopuści inkubator bez regulacji wysokości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

W celu zagwarantowania dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18.03.2019 r. do godziny 12:00.



Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 ze zmianami). Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

1. w SIWZ w dziale XII Miejsce i termin składania i otwarcia ofert, zmianie ulega pkt. 1 i 3:

Było:

1. Oferty należy składać do dnia: 14.03.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, po
kój nr 124 I piętro (sekretariat)
3. Oferty zostaną otwarte dnia 14.03.2019 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego:
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter

Winno być:

1. **Oferty należy składać do dnia: 18.03.2019 r. do godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego:
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat)
3. **Oferty zostaną otwarte dnia: 18.03.2019 r. o godz. 15:00** w siedzibie Zamawiającego:
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto działając na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie. Zmianę ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu dzisiejszym.

W imieniu Zamawiającego:

REKTOR

dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSiIP



15lat
PWSiIP
w Łomży

Projekt „Centrum Symulacji Medycznej przy PWSiIP w Łomży” nr POWR.05.03.00-00-0085/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 – Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych